

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



11 Veröffentlichungsnummer:

1 56 961
A2

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 84113547.9

51 Int. Cl.: **A 61 K 37/14, A 61 K 35/14,**
C 07 K 3/26

22 Anmeldetag: 09.11.84

30 Priorität: 31.03.84 DE 3412144

71 Anmelder: Biocast Pharma GmbH, Flughafenstrasse 4,
D-6000 Frankfurt 71 (DE)

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 09.10.85
Patentblatt 85/41


72 Erfinder: Kothe, Norbert, Dr. Dipl.-Chem.,
Friedrich-Ebert-Strasse 21, D-8242 Kronberg (DE)
Erfinder: Eichenkopf, Bertram, Dr. Dipl.-Pharm., Im
Lauer 7, D-6232 Bad Roden (DE)

64 Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR GB IT LI LU
NL SE

74 Vertreter: Wolff, Hans-Joachim, Dr. jur. Dipl.-Chem. et al,
Beil, Wolff & Beil Rechtsanwälte
Postfach 80 01 40 Adlonstrasse 58, D-6030 Frankfurt am
Main 80 (DE)

84 Verfahren zur Herstellung hochgereinigter, stromafrater, hepatoxischer Human- und Tierhämoglobinklösungen.

85 Zur Erzielung eines Verfahrens, das die Herstellung hochgereinigter Hämoglobinklösungen für die Humantherapie, die frei von Plasmaproteinen und Reststromalipiden sind, nicht nur aus Humanblut, sondern auch aus Tierblut in so großen Mengen erlaubt, wie sie für eine klinische Anwendung benötigt werden, (a) pumpt man das Erythrozyten enthaltende Ausgangsmaterial über eine Filtereinheit einer Porengröße zwischen 0,1 und 1,2 μ m im Kreislauf gegen eine isotonische Waschlösung, (b) hämolysiert das Produkt von (a) und pumpt es über eine Ultrafiltrationseinheit mit Durchlässigkeit von 80 000 bis 100 000 D im Kreislauf gegen Wasser und (c) pumpt und dialysiert das in Stufe (b) anfallende Ultrafiltrat über eine Ultrafiltrationseinheit mit Durchlässigkeit von 10 000 bis 50 000 D im Kreislauf gegen Wasser, wobei vor und/oder nach der Dialyse ankonzentriert wird.

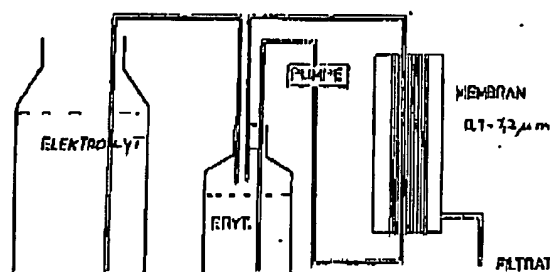

EP 0 156 961 A2

ACTORUM AG

0156961

- 1 -

Unsere Nr. 24 588

Pr/br

5

Biotest Pharma GmbH
Flughafenstraße 4
6000 Frankfurt 71

10

Verfahren zur Herstellung hochgereinigter,
stromafreier, hepatitissicherer Human- und
Tierhäoglobinlösungen.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung
15 hochgereinigter, stromafreier, hepatitissicherer Human-
und Tierhäoglobinlösungen.

Häoglobinlösungen sind in der Lage, unabhängig von
Erythrozyten in vivo Sauerstoff zu transportieren. Für
20 die Verträglichkeit solcher Lösungen ist es jedoch nötig,
Plasma und Zellbestandteile des Blutes, aus dem das Hämo-
globin durch Hämolysen freigesetzt wird, möglichst voll-
ständig zu entfernen (Plasmaproteine, Stroma, etc.).

25 Zur Herstellung von Häoglobinlösungen werden verschie-
dene Verfahren angewandt.

30

0156961

- 2 -

In der ersten Stufe erfolgt bei allen Verfahren eine Waschung der Erythrozyten, um die Plasmaproteine zu entfernen.

5 In den meisten der bisher bekannten Verfahren werden die Erythrozyten mit isotonen Elektrolytlösungen versetzt und durch Zentrifugation abgetrennt, wie beispielsweise gemäß der DE-PS 22 48 475.

10 In der DE-OS 31 30 770 wird ein Verfahren beschrieben, das auch für die großtechnische Herstellung geeignet ist und eine Sedimentation zur Waschung der Erythrozyten beinhaltet.

15 Gemeinsame nächste Stufe aller Herstellungsverfahren ist eine Hämolysen der Erythrozyten mit nachfolgender Abtrennung der Stromabestandteile, die entweder durch Filtration, Zentrifugation, Umkristallisation des Hämoglobins oder einer Kombination dieser Methoden erfolgen kann (DE-OS 31 30 770, De Venuto et al. "Appraisal of
20 Hemoglobin Solution as a Blood Substitute", Surgery, Gynecology & Obstetrics, Sept. 1979, Bd. 149, S. 417-436; F. De Venuto et al "Characteristics of stroma free hemoglobin prepared by crystallization", J. Lab. Clin. Med., März 1977, S. 509-516; Mario Feola et al "Development
25 of a bovine stroma-free hemoglobin solution as a blood substitute", Surgery, Gynecology & Obstetrics, November 1983).

30 Dieser möglichst vollständigen Stromaabtrennung kommt eine besondere Bedeutung zu, da Reststromalipide unter Umständen die Blutgerinnung beeinflussen und Nierenschäden hervorrufen können.

0156961

-3-

- Alle bisher zur Herstellung von Hämoglobinlösungen angewandten Verfahren weisen noch entscheidende Nachteile auf. Die Waschung der Erythrozyten in der bisher durchgeführten Weise führt zu Produkten, die noch Plasmaproteine enthalten. Eine vollständige Entfernung der Plasmaproteine durch wiederholte Waschung der Erythrozyten oder Umkristallisation des Hämoglobins führt zu erheblichen Ausbeuteverlusten und ist im großtechnischen Maßstab unwirtschaftlich.
- Aus diesem Grunde war es auch bisher mit herkömmlichen Verfahren nicht möglich, in der Humanmedizin möglicherweise anzuwendende Hämoglobinlösungen aus Tierblut herzustellen, da die in den Lösungen vorhandenen Restproteine bei Anwendung am Menschen zu Immunreaktionen führen können.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren bereitzustellen, das die Herstellung hochgereinigter Hämoglobinlösungen für die Humantherapie, die frei von Plasmaproteinen und Reststromalipiden sind, nicht nur aus Humanblut, sondern auch aus Tierblut in so großen Mengen erlaubt, wie sie für eine klinische Anwendung benötigt werden.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß man

30

0156961

- 4 -

- 5 a) das Erythrozyten enthaltende Ausgangsmaterial über eine zu überströmende Filtereinheit einer Porengröße zwischen 0,1 und 1,2 μm im Kreislauf gegen eine isotone Waschlösung pumpt, wobei verbrauchte Waschlösung als Filtrat kontinuierlich abgezogen und durch neue Waschlösung ergänzt wird,
- 10 b) die so gewaschenen und ankonzentrierten Erythrozyten vom Filter gewinnt und in an sich bekannter Weise hämolysiert, das Hämolysat bei nahezu konstantem Volumen über eine zu überströmende Ultrafiltrationseinheit mit einer Durchlässigkeit von 80 000 bis 100 000 D im Kreislauf gegen Wasser pumpt und
- 15 c) die in Stufe b) als Ultrafiltrat anfallende verdünnte Hämoglobinlösung bei nahezu konstantem Volumen über eine zu überströmende Ultrafiltrationseinheit mit einer Durchlässigkeit von 10 000 bis 50 000 D im Kreislauf gegen Wasser pumpt und dabei dia-
- 20 filtrierte, wobei vor und/oder nach der Diafiltration durch die gleiche Ultrafiltrationseinheit ohne Wassergegenstrom solange im Kreislauf gepumpt wird, bis das Hämoglobin auf den gewünschten Wert ankonzentriert ist.
- 25
- 30

0156961

-5-

Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Kombination von Fil-
trationen mit Filtermembranen absteigender Porendurch-
messer gelingt es, die Erythrozyten von Plasmaproteinen
zu befreien, nach Lyse die Erythrozytenhüllen vollstän-
5 dig zu entfernen und das Hämoglobin von unerwünschten
Begleitsubstanzen zu reinigen.

Die in Fig. 1 schematisch gezeigte erste Verfahrensstufe
stellt die Erythrozyten-Waschung dar, bei der die Ery-
throzyten im Kreislauf über eine Filtereinheit gegen
10 eine isotone Waschlösung gepumpt werden. Dabei
lassen sich technische Pumpen und technische Filtra-
tionsmodulen einsetzen, wie sie z.B. üblicherweise zur
Rückgewinnung von Lackpigmenten verwendet werden.

15 Bekanntlich unterliegen Erythrozyten sehr leicht der
Hämolyse, und der Fachmann ist stets bemüht, Erythrozyten
so schonend wie möglich zu waschen, um Hämolyse zu ver-
meiden. Ganz besonders empfindlich gegenüber Hämolyse
20 sind alte, überlagerte Erythrozyten-Konzentrate.

Es war deshalb völlig überraschend, daß bei einem Im-
Kreislauf-Pumpen unter Verwendung technischer Pumpen
über technische Filtermodule, was dem Fachmann nicht
25 gerade als schonende Behandlung anmuten mußte,
kaum Hämolyse erfolgte, was ganz besonders überraschend
für den Einsatz überlagelter Erythrozyten-Konzentrate
war.

30 Somit läßt sich das erfindungsgemäße Verfahren nicht
nur bei frischem Vollblut tierischer und humaner Her-
kunft, sondern auch bei überlagerten Human-Erythrozyten-
Konzentraten anwenden, ohne daß eine nennenswerte
Hämolyse eintritt.

0156961

-6-

Mit Hilfe dieser ersten Verfahrensstufe gelingt es, in kurzer Zeit große Mengen Waschlösung mit Erythrozyten in Kontakt zu bringen und wieder aus dem Kreislauf zu entfernen, so daß eine intensive Waschung erfolgt.

5

Als Waschlösung eignen sich jegliche isotone Elektrolytlösungen sowie isotone Lösungen von Zucker oder Zuckeralkoholen. Eine bevorzugte Waschlösung ist isotone NaCl-Lösung.

10

10

Durch Vergrößerung der Filterflächen lassen sich beliebige Erythrozytenvolumina waschen, so daß dieses Verfahren für die großtechnische Herstellung von Hämoglobinslösungen geeignet ist.

15

Die verwendeten Filter können sowohl Flach- als auch Hohlfasermembranen enthalten. Hohlfasermembranen werden bevorzugt, weil sie mehr Fläche auf kleinem Raum aufweisen als Flachmembranen.

20

Die durchschnittliche Porengröße liegt zwischen 0,1 und 1,2 μm . Bei Unterschreitung der unteren Grenze könnten Plasmaproteine mit den Erythrozyten zurückgehalten werden, während bei Überschreiten der oberen Grenze sich die Hämolyserate drastisch erhöht. Vorzugsweise werden Membranen mit einer mittleren Porengröße von 0,4 bis 0,6 μm verwendet.

25

Der Filtrationsdruck sollte zweckmäßigerweise zwischen 50 und 700 mbar liegen.

30

Die Kreislaufwäsche erfolgt so lange, bis keine Plasmaproteine mehr nachweisbar sind.

35

0156961

-7-

Nach Waschung der Erythrozyten in der beschriebenen Art und Weise erfolgt die Hämolyse durch Einbringen der an-konzentrierten Erythrozyten in das 2-3 fache Volumen Wasser.

5

Die in Fig. 2 gezeigte zweite und dritte Verfahrensstufe stellt die Abtrennung des Stromas vom Hämoglobin dar, dabei wird unmittelbar anschließend an die Hämolyse das aus den Erythrozyten freigesetzte Hämoglobin in einer
10 zweiten Filtrationsstufe von dem Erythrozytenstroma abgetrennt. Hierzu wird das Hämolysat intensiv gegen Wasser diafiltriert, wobei eine Ultrafiltrationseinheit mit einer Durchlässigkeit von 80 000 bis 100 000 D verwendet wird (Flachmembranen oder Hohlfasermembranen,
15 vorzugsweise Hohlfasermembranen).

Dies bedeutet, daß das Hämolysat bei nahezu konstantem Volumen im Kreislauf über die Ultrafiltrationseinheit gepumpt wird, wobei das Hämoglobin mit einem Molekulargewicht
20 von 64 500 zusammen mit allen Begleitstoffen, deren Molekulargewicht weniger als 80 000 bis 100 000 D beträgt, im Ultrafiltrat erscheint.

Vorteil dieses Verfahrens ist, daß nahezu das gesamte
25 Hämoglobin aus dem vorliegenden Hämolysat gewonnen werden kann, im Gegensatz zu bisher bekannten Verfahren, bei denen ein Großteil des Hämoglobins zusammen mit dem Erythrozytenstroma verworfen wird.

30

0156961

- 8 -

Die in dieser zweiten Filtrationsstufe als Ultrafiltrat anfallende verdünnte Hämoglobinlösung wird in einer dritten Filtrationsstufe, parallel zur zweiten Filtration, ankonzentriert. Verwendet wird wiederum eine Ultra-
5 filtrationseinheit, jedoch mit einer Durchlässigkeit von 10 000 bis 50 000 D, so daß das Hämoglobin zurückgehalten wird und damit sowohl ankonzentriert als auch bereits teilweise von Begleitsubstanzen mit Molekulargewichten unter der genannten Durchlässigkeit der eingesetzten Membran befreit wird. Sobald das Hämoglobin
10 auf einen erwünschten Wert ankonzentriert ist, wird zur vollständigen Abreicherung kleinmolekularer Begleitstoffe erneut gegen Wasser diafiltriert.

15 Die Diafiltration kann jedoch praktisch an jeder Stelle der dritten Filtrationsstufe erfolgen. Es kann beispielsweise erst diafiltriert und dann konzentriert werden oder umgekehrt. Nachdem jedoch zum Zwecke des Diafiltrierens das Volumen der Hämoglobinlösung weder zu groß noch die
20 Lösung zu konzentriert sein sollte, erfolgt die Diafiltration zweckmäßigerweise etwa in der Mitte der dritten Stufe, d.h. es wird erst auf einen gewissen Wert ankonzentriert, dann diafiltriert und danach auf die gewünschte Endkonzentration eingestellt.

25 Der Filtrationsdruck in der zweiten und dritten Filtrationsstufe erfährt seine Begrenzung lediglich durch den Maximaldruck, der für die jeweiligen entsprechenden Filtermodule zulässig ist. Dieser ist vom Hersteller auf den
30 Modulen angegeben.

0156961

-9-

Es resultiert ein hochgereinigtes Hämoglobin gewünschter Konzentration, das nach üblichen Verfahren zu modifizierten Hämoglobinlösungen verarbeitet werden kann, wie beispielsweise in DE-PS 24 49 252, 26 17 822 und
5 27 14 252 beschrieben, wobei sich vorstehende Literaturangaben nur auf Modifizieren und nicht auf Reinigen beziehen sollen.

Bei den Filtrationen in allen drei Stufen handelt es
10 sich um sogenannte tangential überströmende Filtrationen. Bei einer üblichen Filtration würden bei dem zu filtrierenden Material sehr schnell die Poren verstopfen.

Als Wasser wird zweckmäßigerweise entsalztes oder
15 destilliertes Wasser genommen.

Das in der bereits vorstehend genannten Druckschrift Mario Feola et al. beschriebene Verfahren zur Herstellung von Hämoglobinlösungen beinhaltet zwar auch zwei Stufen,
20 in denen das Hämolysat hintereinander durch Filter mit einer Durchlässigkeit von 100 000 D und 30 000 D geschickt wird. Die vorangehende Erythrozyten-Waschung erfolgt in diesem Verfahren jedoch auf übliche Weise mit einer Elektrolytlösung, wobei keine vollständige
25 Abtrennung des Plasmaproteins erfolgt. Ferner wird das Ultrafiltrat aus der letzten 30 000 D-Filtration gegen einen Elektrolyten dialysiert, was zur Folge hat, daß die daraus resultierende Hämoglobinlösung einen hohen Elektrolytgehalt aufweist, was für spezielle Verwendungszwecke, z.B. Perfusion der Herzkranzgefäße bei Operationen
30 am offenen Herzen (Kardioplegie) von Nachteil ist. Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem in

35

0156961

-10-

der zweiten und dritten Stufe gegen Wasser diafiltriert wird, wird dagegen ein praktisch elektrolytfreies Produkt erhalten.

5 Schließlich ist den beiden Ultrafiltrationen nach erfolgter Hämolyse eine Filtration durch ein Filter mit einer Porengröße von 0,5 μ m vorgeschaltet, weil der Fachmann annehmen mußte, daß bei der Filtration eines Hämolysats, das noch alle groben Zellbestandteile enthält, unmittelbar durch ein 100 000 D Filter, dieses Filter sehr schnell verstopfen würde.

10 Überraschenderweise fand man jedoch, daß, wenn man gemäß der Erfindung das Hämolysat über ein 100 000 D Filter im Kreislauf gegen Wasser pumpt, keine Filterverstopfung stattfindet und eine vorgeschaltete Filtrationsstufe für das Hämolysat durch ein gröberes Filter entfallen kann.

Die Vorteile des erfindungsgemäßen Kombinationsverfahrens liegen zum einen in der technisch einfachen Realisierbarkeit, verbunden mit einem beträchtlichen Zeitgewinn und einer erhöhten Hämoglobinausbeute gegenüber bisher beschriebenen Verfahren; zum anderen ermöglicht die hohe Reinheit des so gewonnenen Hämoglobins möglicherweise den Einsatz von Tierblut zur Herstellung modifizierter Hämoglobinlösungen für die Humantherapie. Darüberhinaus ist das Produkt praktisch frei von Elektrolyten, und das Verfahren führt zu einer drastischen Reduzierung eventuell im Ausgangsmaterial vorhandener Bakterien oder Viren, so daß auch die aus bisherigen Verfahren bekannte chemische Sterilisation, beispielsweise mit β -Propiolacton (z.B. DE-PS 22 48 475, DE-OS 31 30 770) entfallen kann. Für besondere Fälle läßt sich jedoch gegebenenfalls eine β -Propiolactonbehandlung auch beim erfindungsgemäßen Verfahren während der Erythrozyten-Waschung durchführen.

0156961

-11-

Nachstehende Beispiele dienen der weiteren Erläuterung der Erfindung.

Beispiel 1

- 5 5 l frisches, stabilisiertes Rinderblut wurde über ein Blutfilter in ein 5 l-Gefäß filtriert. Mit Hilfe einer Blutpumpe wurde das Blut im Kreislauf über zwei Hohlfilterfiltrationspatronen der Porenweite 0,4 μ m und einer
10 Gesamtfläche von 1 m² gepumpt. Das aus dem Kreislauf abfiltrierte Volumen wurde kontinuierlich durch 0,9%ige NaCl-Lösung ersetzt. Zur nahezu vollständigen Entfernung der Plasmaproteine wurden 50 l (10-faches Ausgangsvolumen) NaCl-Lösung zur Waschung eingesetzt. Der
15 mittlere Filtrationsdruck betrug 266 mbar. Die Waschung war in 3 Stunden beendet. Danach wurden die Erythrozyten auf 2,5 l ankonzentriert. Dieses Erythrozytenkonzentrat wurde in 5 l destilliertes Wasser eingerührt, wobei Hämolyse eintrat. Zur Stromaentfernung wurde das Hämolysat
20 im Kreislauf über 2 Hohlfilterpatronen (1,8 m²) der Durchlässigkeit 100 000 D gepumpt. Das Hämoglobin (MG 64 500) passierte die Membran, während die Stromabestandteile und höhermolekularen Substanzen zurückgehalten wurden. Das Kreislaufvolumen wurde durch kontinuierliche Zugabe von
25 destilliertem Wasser konstant gehalten. In 30 l Ultrafiltrat waren ca. 95 % des gesamten Hämoglobins enthalten. Sobald 5 l Ultrafiltrat vorlagen, wurde unter Konstanthaltung des Volumens das Hämoglobin in einem weiteren Kreislauf, in dem sich zwei Hohlfilterpatronen
30 der Durchlässigkeit 10 000 D (1,8 m²) befanden, ankonzentriert. Sobald die Stromaabtrennung beendet war und 95 % des Gesamthämoglobins in dem Volumen von 5 l vorlagen, wurde zur Entfernung niedermolekularer Bestandteile über die gleiche

0156961

-12-

Ultrafiltrationseinheit mit einer Durchlässigkeit von 10 000 D gegen 25 l destillierten Wassers diafiltriert. Im letzten Schritt wurde im selben Kreislauf auf 22 % Hämoglobin ankonzentriert. Anschließend wurde die Lösung über ein 0,2 μ m Filter steriltfiltriert.

Ausbeute: 80 %.

10 Beispiel 2

Die vollständige Entfernung der Plasmaproteine aus der Hämoglobininlösung ließ sich anhand von Immunelektrophoresen und im Tierexperiment zeigen. Hierzu wurden Meer-
15 schweinchen mit einer nach Beispiel 1 hergestellten Hämoglobininlösung unter Zuhilfenahme von Freund'schem Adjuvans immunisiert. Im Plasma der Tiere ließen sich keine Antikörper gegen Humanplasmaproteine bzw. gegen tierische Plasmaproteine nachweisen

20

Beispiel 3

Die drastische Verringerung vorhandener Erreger im Ausgangsblut durch das erfindungsgemäße Verfahren ließ sich
25 ebenfalls im Experiment zeigen. Setzte man dem zur Herstellung der Hämoglobininlösung verwendeten Blut entweder ϕ X 174 Phagen mit einem Durchmesser von ca. 25nm oder K Phagen mit einem Durchmesser von 200 nm in einer Konzentration von 10^7 /ml zu, so ließ sich zeigen, daß durch
30 Waschung der Erythrozyten mit dem 10-fachen Waschlösungsvolumen in der ersten Filtrationsstufe eine Abreicherung um 10^3 - 10^4 Phagen erfolgt.

In der nächsten Filtrationsstufe, bei dem das freige-
35 setzte Hämoglobin durch eine Ultrafiltrationsmembran mit einer Durchlässigkeit von 100 000 D abfiltriert wurde, wurden weitere 10^3 /ml Phagen durch die Membran

0156961

-13-

zurückgehalten, da sie aufgrund ihres Durchmessers die Membran nicht passieren konnten. Insgesamt wurden damit die zugesetzten Phagen um ca. 10^6 /ml, also auf 10/ml, verringert. Dieser Sterilisationseffekt ist deshalb
5 von besonderer Bedeutung, weil nach üblichen Blutbankkriterien geprüfetes Transfusionsblut nach wie vor eine Hepatitis übertragen kann. Wie an früherer Stelle bereits ausgeführt, war bei bisherigen Verfahren deshalb ein chemisches Sterilisationsverfahren erforderlich. Durch
10 das hier beschriebene Filtrationsverfahren kann eine solche chemische Sterilisation entfallen.

45

0156961

-14-

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Verfahren zur Herstellung hochgereinigter, stroma-
freier hepatitis-sicherer Human- und Tierhämoglobin-
lösungen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h -
n e t, daß man
- a) das Erythrozyten enthaltende Ausgangsmaterial über
eine zu überströmende Filtereinheit einer Poren-
größe zwischen 0,1 und 1,2 μ m im Kreislauf gegen
eine isotone Waschlösung pumpt, wobei verbrauchte
Waschlösung als Filtrat kontinuierlich abgezogen
und durch neue Waschlösung ergänzt wird,
- b) die so gewaschenen und ankonzentrierten Erythrozyten
vom Filter gewinnt und in an sich bekannter Weise
hämolyisiert, das Hämolysat bei nahezu konstantem
Volumen über eine zu überströmende Ultrafiltrations-
einheit mit einer Durchlässigkeit von 80 000
bis 100 000 D im Kreislauf gegen Wasser pumpt und
- c) die in Stufe b) als Ultrafiltrat anfallende verdünn-
te Hämoglobininlösung bei nahezu konstantem Volumen
über eine zu überströmende Ultrafiltrationseinheit
mit einer Durchlässigkeit von 10 000 bis 50 000 D
im Kreislauf gegen Wasser pumpt und dabei dia-
filtriert, wobei vor und/oder nach der Diafil-
tration durch die gleiche Ultrafiltrationseinheit
ohne Wassergegenstrom solange im Kreislauf gepumpt
wird, bis das Hämoglobin auf den gewünschten Wert
ankonzentriert ist.

0156961

-15-

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß man zuerst im Kreislauf pumpt, bis das Hämoglobin auf den gewünschten Wert ankonzentriert ist,
danach durch die gleiche Ultrafiltrationseinheit .
5 im Kreislauf gegen Wasser diafiltriert und dann
das Hämoglobin auf die gewünschte Endkonzentration
einstellt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
10 daß in Stufe a) bei einem Filtrationsdruck von
50 bis 700 mbar gearbeitet wird.
4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß als Waschlösung in
15 Stufe a) isotone NaCl-Lösung verwendet wird.
5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß man in Stufe a) eine
Filtrationseinheit mit einer Porengröße von 0,4
20 bis 0,6 μm verwendet.
6. Vrfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß man in allen drei Stufen
als Filtrations- bzw. Ultrafiltrationseinheit eine
25 Hohlfasermembran verwendet.

30

35

-1/2

0156961

FIG.1 ERYTHROZYTEN-WASCHUNG

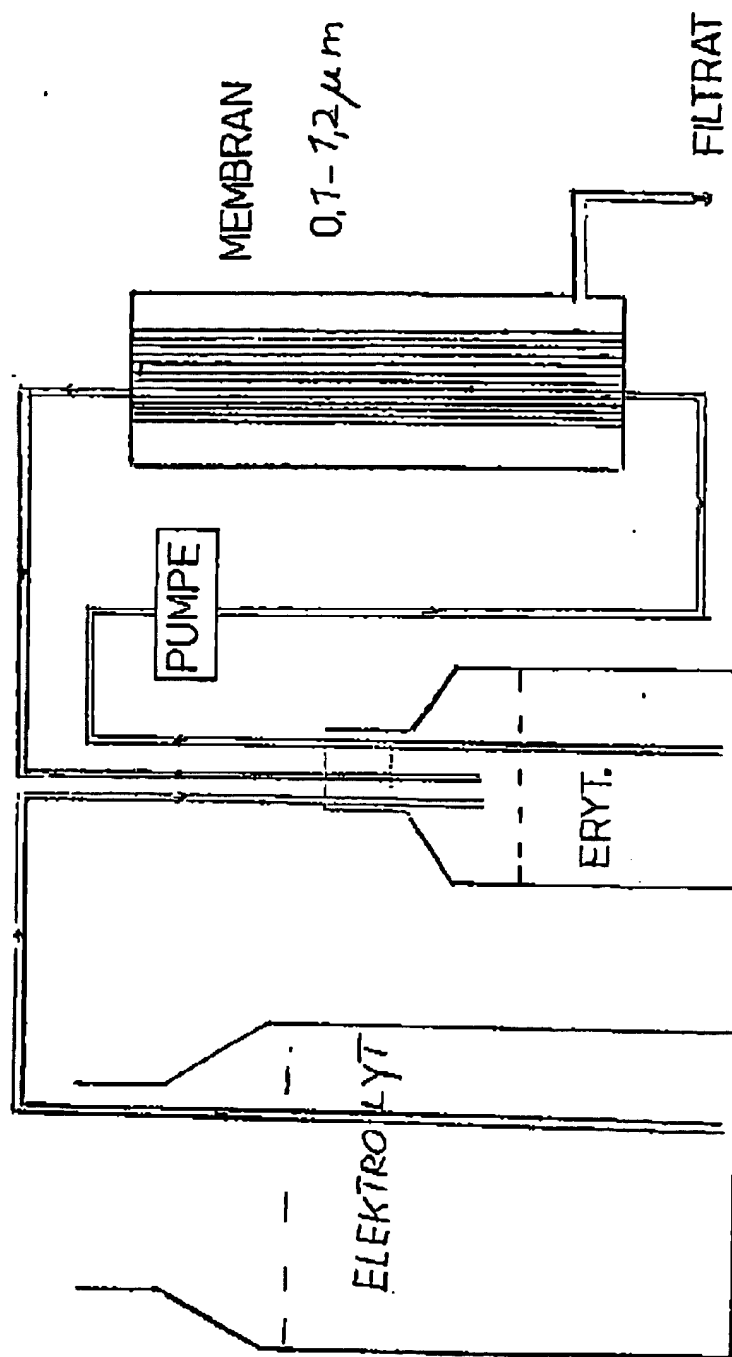


FIG.2 STROMA-ABTRENNUNG

